Éprouvettes graduées Hirschmann® en verre Duran® classe A ou classe B

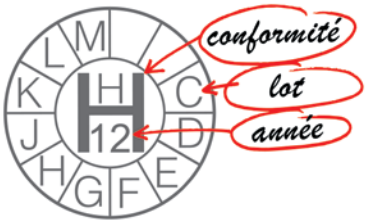

- éprouvettes graduées Hirschmann® en verre Duran® classe A ou classe B certifiées conformes DIN 12680 T2 ou DIN 12685 T2 selon les modèles
- graduations ambrées ou bleues
- certificat de qualité supérieure gravé d'un logo "H" certifié conforme avec numéro de lot et année de production

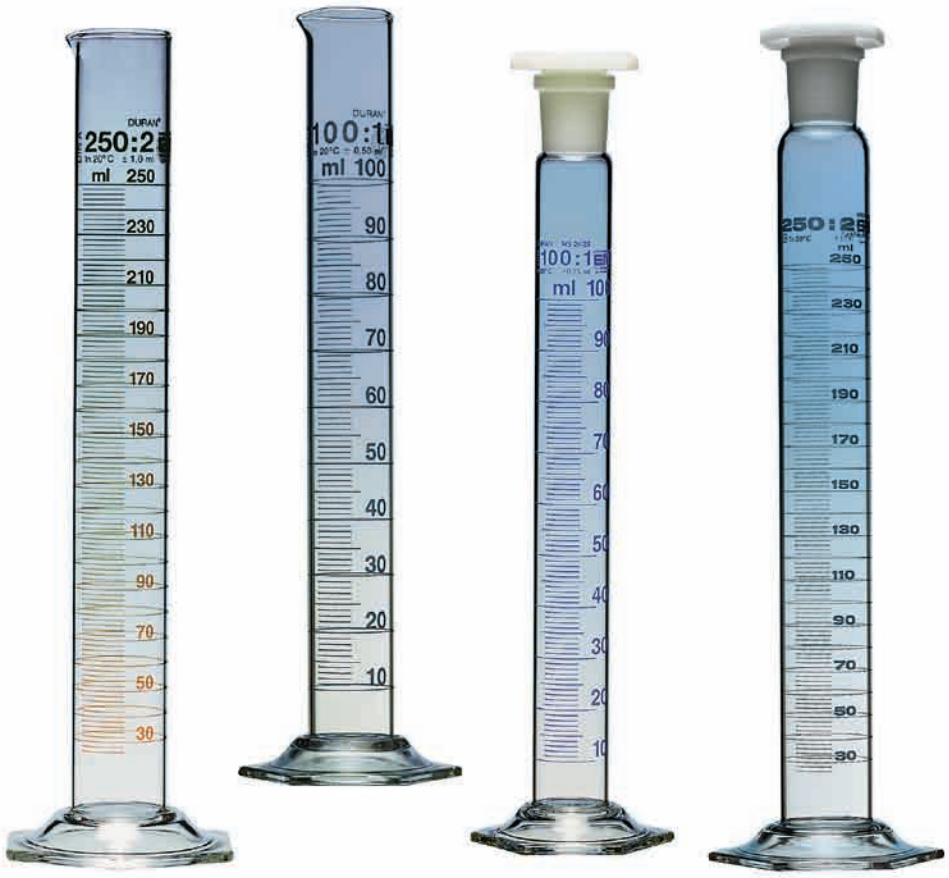

certificat d'étalonnage individuel

Conforme aux normes ISO, le certificat d'étalonnage usine individuel permet de mesurer la tolérance pour plusieurs volumes nominaux et d'informer l'utilisateur sur l'exactitude de l'instrument utilisé.

référence	Prix HT
HL2000 Certificat d'étalonnage usine individuel	

capacité	subdivisions	tolérance classe A / B	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT
			classe A		classe A		classe A		classe B	
			graduations ambrées bec verseur DIN 12680 T2		graduations bleues bec verseur DIN 12680 T2		graduations bleues bouchon en PE DIN12685 T2		graduations bleues bouchon en PE DIN12685 T2	
5 ml	0,1 ml	± 0,05 / ml	**HL4154**		**HL4254**		-	-	-	-
10 ml	0,2 ml	± 0,10 / 0,15 ml	**HL4160**		**HL4260**		**HL4360**		**HL4460**	
25 ml	0,5 ml	± 0,25 / 0,37 ml	**HL4170**		**HL4270**		**HL4370**		**HL4470**	
50 ml	1,0 ml	± 0,50 / 0,75 ml	**HL4175**		**HL4275**		**HL4375**		**HL4475**	
100 ml	1,0 ml	± 0,50 / 0,75 ml	**HL4180**		**HL4280**		**HL4380**		**HL4480**	
250 ml	2,0 ml	± 1,00 / 1,50 ml	**HL4186**		**HL4286**		**HL4386**		**HL4486**	
500 ml	5,0 ml	± 2,50 / 3,75 ml	**HL4190**		**HL4290**		**HL4390**		**HL4490**	
1000 ml	10,0 ml	± 5,00 / 7,50 ml	**HL4193**		**HL4293**		**HL4393**		**HL4493**	
2000 ml	20,0 ml	± 10,00 / 15,00 ml	**HL4194**		**HL4294**		**HL4394**		**HL4494**	

LABOMODERNE
www.labomoderne.com - info@labomoderne.com
Tél. 01 42 50 50 50 - Fax 01 45 32 01 09
Prix HT départ au 01.10.2011, sans engagement